

函館で研修
教授が講演



亜硫酸について説明する

ワインの酸化防止法解説

ンの酸化防止剤についての講演会が行われ、道内各地のワイナリー関係者など約50人が熱心に耳を傾けた。

ルベル教授はワインの酸化を防ぎ、香りを保つための亜硫酸について説明。頭痛やアレルギー反応を起こす人もいることから、近年は使用量を抑えたワインの

ての最小限の量に亜硫酸を抑えることが必要」と話した。

同アカデミーは道産ワインの醸造技術やマーケティング力を高める狙いで2016年に始まった。道南研修は初めてで、今年は道内各地や山梨県などで研修を予定。24日は市内の「レス

トラン・バス」の深谷宏


人減る見通しを示し、私立校が「2学級減(80人)」は実情に合っているのか」と

機器の点検・整備済み 一目で識別

函館五稜郭病院臨床工学科長の雲母公貴さん(46)が開発した、医療機器の点検・整備済みを識別するテープが、全国の臨床工学技士が開発した商品を競うコンテストで全国3位に当たる「審査員特別賞」を受けた。

機器の使い回しを防ぎ、感染症予防に効果があると評価され、使用は全国約200病院に拡大。雲母さんは「現場のアイデアが活用されて、医療の安全に役立つ商品を開発できてうれしい」と喜んでいる。

受賞したのは、商品名「点検バン」で、「点検・整備済み」と印字されている幅1・8センチ、長さ50cmの不織布製テープ。点滴の液量を調整する「輸液ポンプ」や人工呼吸器などを使用した際、医療機器の専門家である「臨床工学技士」が除菌や破損

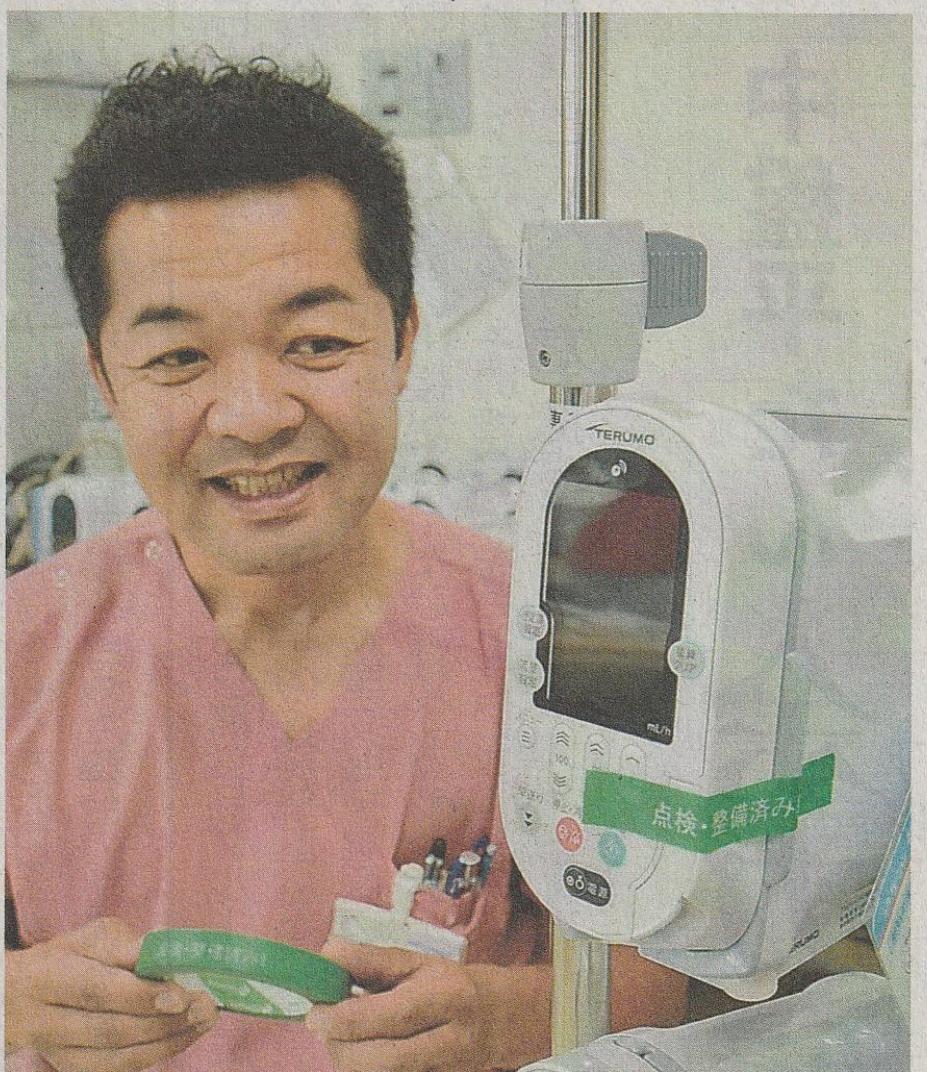

自らが考案した「点検バン」を輸液ポンプに張り、使い方などを説明する雲母さん

14年から1箱(10巻入り)8800円(税別)で全国発売されている。各医療機関の好評を受け、点検バンは5月、臨床工学技士の全国組織「日本臨床工学技士会」が、優れた商品開発事例を評価する「第1回医工連携Award(アワード)」で審査員特別賞を受けた。雲母さんは「価値のある仕事ができてよかったです。仕事を通じ、さらに地域の医療に貢献していきたい」と話している。(青山修二)

照井氏に当選証書

「誠実に町政執行」

【江差】町選挙管理委員会は23日、17日に告示さ

た江差町長選で、無投票選した照井薦之介氏(33)、当選証書を手渡した。

町役場で、町選管の松

仁委員長が照井氏に当選

書を手渡し「今後4年間、

しっかりと町政のかじ取

をお願いします」と激励

た。照井氏は「町民の負

医療用テープ 全国表彰

函館五稜郭病院臨床工学科長の雲母公貴さん(46)が開発した、医療機器の点検・整備済みを識別するテープが、全国の臨床工学技士が開発した商品を競うコンテストで全国3位に当たる「審査員特別賞」を受けた。

機器の使い回しを防止でき、B型肝炎などの感染の可能性を下げられるという。

五稜郭病院・雲母さん考案 感染症予防に効果

開発は2009年、全国の病院の医療の質を評価する第三者機関から、五稜郭病院に「使用

前、使用後の機器が混在する可能性がある」と指摘されたこと

がないかの点検を行った後、電

源近くに貼る。これにより、機

器の使い回しを防止でき、B型

がきっかけだった。雲母さんは、

臨床工学技士会(札幌)から改

はがした後ものが残りにくく、安全性が高い野菜結束用の

く、材質などの見直しを続け、

院の医療の質を評価する第三者機関から、五稜郭病院に「使用

前、使用後の機器が混在する可

能性がある」と指摘されたこと

がないかの点検を行った後、電

源近くに貼る。これにより、機

器の使い回しを防止でき、B型

がきっかけだった。雲母さんは、

臨床工学技士会(札幌)から改

はがした後ものが残りにくく、安全性が高い野菜結束用の

く、材質などの見直しを続け、

院の医療の質を評価する第三者機関から、五稜郭病院に「使用

前、使用後の機器が混在する可能性がある」と指摘されたこと

がないかの点検を行った後、電

源近くに貼る。これにより、機

器の使い回しを防止でき、B型

がきっかけだった。雲母さんは、

臨床工学技士会(札幌)から改

はがした後ものが残りにくく、安全性が高い野菜結束用の

く、材質などの見直しを続け、

院の医療の質を評価する第三者機関から、五稜郭病院に「使用

前、使用後の機器が混在する可能性がある」と指摘されたこと

がないかの点検を行った後、電

源近くに貼る。これにより、機

器の使い回しを防止でき、B型

がきっかけだった。雲母さんは、

臨床工学技士会(札幌)から改

はがした後ものが残りにくく、安全性が高い野菜結束用の

く、材質などの見直しを続け、